

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti

Prot. 0217506

Roma, li 09.12.2019

AVVISO


Con Deliberazione n. 2278 del 07.11.2019 l'Azienda A.S.L. Roma 2 ha formalizzato l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la fornitura biennale in service di lavaendoscopi a vasca singola o a vasca doppia asincrona, per l'alta disinfezione di endoscopi flessibili per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della Asl Roma 2, meglio descritta nel prospetto che si allega al presente Avviso (All. n. 1), per un importo annuale a base d'asta pari ad € 110.400,00=(Iva esclusa).

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.


Pertanto, le ditte che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno richiedere, entro e non oltre il giorno 16/12/2019, alla U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti, all'indirizzo pec procedure.acquisto@pec.aslroma2.it, di essere formalmente invitati utilizzando il modello all'uopo allegato (All. n. 2).

Scaduto il suddetto termine, sarà cura della suddetta Struttura amministrativa comunicare alle Imprese che hanno presentato formale istanza di partecipazione, tempi e modalità di espletamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ilaria Simeoni



Il Coordinatore
Sabrina Cenciarelli

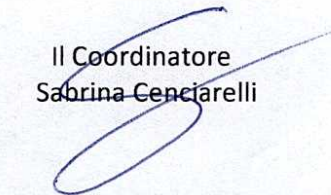

“Allegato 1” all’Avviso

CARATTERISTICHE TECNICHE

OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI A VASCA SINGOLA O A VASCA DOPPIA ASINCRONA, PER L’ALTA DISINFEZIONE DI ENDOSCOPI FLESSIBILI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA ASL ROMA 2.

Descrizione del servizio:

Si richiedono n. 9 lavaendoscopi nel caso di apparecchiatura a vasca singola, oppure n. 3 lavaendoscopi a doppia vasca asincrona e n. 3 a vasca singola.

I quantitativi devono poter variare del 20% in aumento o diminuzione rispetto a quelli stimati senza comportare aumenti del costo unitario della fornitura, che dovrà essere specificato nell’Offerta Economica.

L’appalto è da intendersi “chiavi in mano” pertanto sono ricomprese le seguenti attività:

- Smontaggio ed accantonamento delle macchine esistenti;
- Bonifica impianto di alimentazione;
- Montaggio delle nuove macchine lavaendoscopi;
- Linea di alimentazione dal Q.E. alla macchina lavaendoscopi.

Le seguenti caratteristiche sono indicative e non esaustive, salvo il disposto di cui all’art. 68 del D.Lgs. 50/16. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

Le apparecchiature dovranno essere installate nei locali adibiti a sale lavaggio dei singoli presidi e dovranno essere complete di quanto occorre per il collegamento agli impianti esistenti, inclusi, se necessari, i miscelatori di acqua fredda-calda.

Non saranno possibili lavori strutturali neanche a carico della ditta aggiudicataria.

Ogni apparecchio lavaendoscopi dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Conformità alle norme UNI EN ISO 15883-1, UNI EN ISO 15883-4;
- Utilizzo di disinfettanti a base di acido peracetico;
- Sistema di lavaggio e disinfezione a circuito chiuso, incluso carico e scarico;
- Utilizzo di detergente/disinfettante (azione virucida e microbattericida) in grado di agire anche sul biofilm microbico;
- Utilizzo di un sistema di filtri per il filtraggio dell’acqua - sarà considerata caratteristica preferenziale la presenza di un filtro batteriologico con possibilità di filtraggio non superiore a 0,2 micron;

- Scarico diretto dei reflui nella rete fognaria in accordo con la normativa vigente sugli scarichi in rete (D.Lgs. 152/2006);
- Funzionamento di tipo single-shot;
- L'apparecchio offerto dovrà prevedere vari cicli di lavaggio (descrivere i vari cicli di lavaggio ed elencare tutte le fasi dei cicli di lavaggio con le relative durate);
- Sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti;
- Durata massima del ciclo standard di lavaggio e disinfezione non superiore a 25 minuti;
- Temperatura del ciclo di disinfezione non superiore a 45° C e comunque controllata e mantenuta durante le diverse fasi del ciclo (le differenti fasi possono avere temperature differenti);
- Temperatura di esercizio durante la fase di disinfezione con variazioni massime consentite del 5%;
- Sistema per l'identificazione dell'endoscopio e dell'operatore;
- Stampante integrata per stampa report del ciclo con dati operatori ed endoscopio;
- Sistema di memoria dei cicli effettuati;
- Possibilità di trasferire i dati su supporto USB (o altri) e su PC;
- Possibilità di collegamento in rete (collegamento LAN)
- L'apparecchio deve essere dotato di un sistema di tracciabilità certificato;
- Compatibilità con gli endoscopi delle principali marche in commercio: si richiede la fornitura di un numero congruo di adattatori di lavaggio per gli endoscopi;
- Esecuzione del test di tenuta per tutta la durata del ciclo;
- Sistema di controllo del flusso nei canali degli endoscopi per rilevare eventuali occlusioni;
- Il sistema di lavaggio dovrà garantire un trattamento su ogni punto esterno dello strumento, in modo che non ci siano aree di contatto dello strumento su se stesso o con la vasca della macchina;
- Apertura dello sportello possibilmente in modalità hand-free;
- Presenza del ciclo di auto disinfezione possibilmente con avvio ciclo programmabile;
- Ruote per piccoli spostamenti;
- Eseguire, oltre alla disinfezione, anche le fasi di detersione, risciacquo e soffiaggio;
- Sistema per l'eliminazione di eventuali emissioni di vapori possibilmente senza richiedere la presenza di altri sistemi per l'estrazione o il trattamento dell'aria;
- Dimensioni: Larghezza massima 70 cm, profondità massima 90 cm.

MATERIALE MONOUSO

I materiali in oggetto devono essere conformi alla normativa vigente (D.Lgs 46 del 24.02.1997 e s.m.i.) e quindi disporre di marcatura conforme alle direttive 93/42/CEE e risultare iscritti al RDM (repertorio generale dei dispositivi medici).

La fornitura dovrà essere comprensiva del disinfettante in grado di garantire disinfezione ad alto livello con acido peracetico, per il quale devono essere fornite prove microbiologiche di efficacia secondo la normativa comunitaria vigente. Il disinfettante fornito dovrà garantire:

- Che il principio attivo sia conforme alle indicazioni della UNI EN ISO 15883-1/4 e ai parametri indicati dalla EN 14885:2007;

488

- Le compatibilità scarico diretto dei reflui nella rete fognaria in accordo con la normativa vigente sugli scarichi di rete;
- La garanzia di non manipolazione dei prodotti chimici utilizzati;
- La massima riduzione delle operazioni in movimentazione.

Principi di funzionamento:

- Acido peracetico (modalità di utilizzo del disinfettante: concentrato, diluito, con attivatore...).

SS

Allegato "2" all'Avviso

Alla A.S.L. ROMA 2
U.O.C. Procedure d'acquisto e Contratti
Via Primo Carnera, 1
00142 ROMA

OGGETTO: Richiesta partecipazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura biennale in service di lavaendoscopi a vasca singola o a vasca doppia asincrona per l'alta disinfezione di endoscopi flessibili per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della Asl Roma 2, per un importo annuale a base d'asta pari ad € 110.400,00=(Iva esclusa).

Il/La Sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
Nat _ / a _____ il _____
nella qualità di _____
eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _____
forma giuridica _____ codice fiscale _____
Partita IVA n. _____ con sede legale in _____
CAP: _____ Via/piazza _____
Sede amministrativa _____
Numero telefonico: _____ Numero fax: _____
Indirizzo e-mail: _____
PEC _____

C H I E D E

di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura biennale in service di lavaendoscopi a vasca singola o a vasca doppia asincrona per l'alta disinfezione di endoscopi flessibili per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della Asl Roma 2, per un importo annuale a base d'asta pari ad € 110.400,00=(Iva esclusa).

IL SOTTOSCRITTO

(TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE DEL SOTTOSCRITTORE)

(Luogo)

(Data)

48